


Etat de la prothèse	
Statut	OK
Etat de la pile	BOL 
Tension de pile	3,10 V (18 févr. 2013)
Durée Charge	4,4 s pour 20 J (15 févr. 2013 11:41:21)

Résultats
Détails d'épisode reçu
Premier message reçu


Réglages tachy						
	Limite zone	1ère ATP	2ème ATP	1er choc	2ème choc	3 - nième choc
TV1	340 ms	3 * Rafale	3 * Rampe	20 J	40 J	6 * 40 J
TV2	OFF	---	---	---	---	---
FV	280 ms	Rafale		40 J	40 J	6 * 40 J

Réglages Brady	
Mode	VVI
Fréquence de base	40 bpm

Sonde brady	Sonde VD
Imp. de stimulation [ohms]	476
Seuil de stimulation [V]	0,4
Ampl. détection moy/min [mV]	14,8 / 12,3
Programmée [V@ms]	2,5 @ 0,40



Sonde de défibrillation	
Impédance de choc [ohm]	69
Impédance dernier choc [ohms]	86 (15/02/13)

Arythmies ventr. depuis le 18 févr. 2013	TV1	TV2	FV
Episodes	---	---	---
ATP démarrés/efficaces	--- / ---		--- / ---
Chocs chargés/annulés/efficaces	--- / --- / ---		
Dernier épisode: FV (15 févr. 2013 11:41:17)			

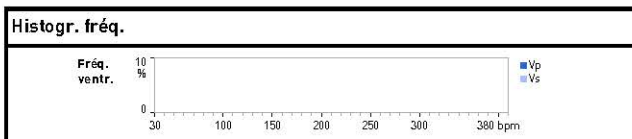

Arythmies atriales depuis 18 févr. 2013	
Épisodes de TSV	---

Episodes d'évènements depuis 18 févr. 2013	
Stimulation	
RVp	---

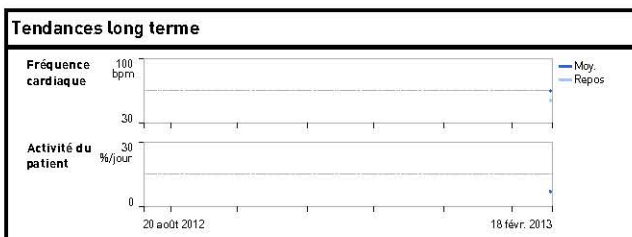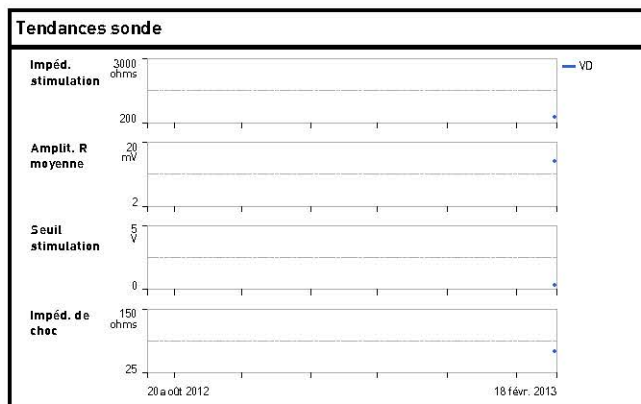

**Statut: JAUNE**

## Statut - Résumé:

### Résumé de statut pour le patient

Catégorie	Statut	Résultat	Info
Enregistrements / Episode	JAUNE	<b>Détails d'épisode reçu</b> Détails d'épisode reçus pour un épisode induit de FV classifié le 15 févr. 2013 11:41:17	<b>Nouveau.</b>
Administratif	JAUNE	<b>Premier message reçu le 18 févr. 2013 19:03:25</b> Veuillez comparer le statut avec les données du dernier suivi	<b>Nouveau.</b>
Remarque : aucun			